


---AUTORIZASE a la firma IRAOLA y CIA SA, la ampliación de vida útil del Reactivo de Diagnóstico uso "in Vitro" de referencia, la que en lo sucesivo será de: VEINTICUATRO (24) MESES, conservad entre 4 - 30°C.-----

---ACÉPTENSE los nuevos proyectos de rótulos y manual de instrucciones a fs. 27 a 44.-----

Expte. 20.970-07-7.-----Disp. 7245 -06-12-07.-----Bs. As. 11-01-08.-----

mem

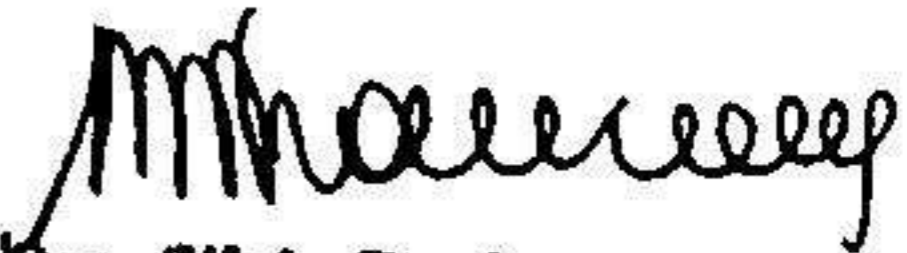

**Dra. Silvia Boni**  
**Jefe de Departamento de Registro**  
**ANMAT**