RScribe 5

PROVEE FLEXIBILIDAD SUPERIOR EN SOLUCIONES DE ECG EN REPOSO

SISTEMA ELECTROCARDIÓGRAFO de reposo

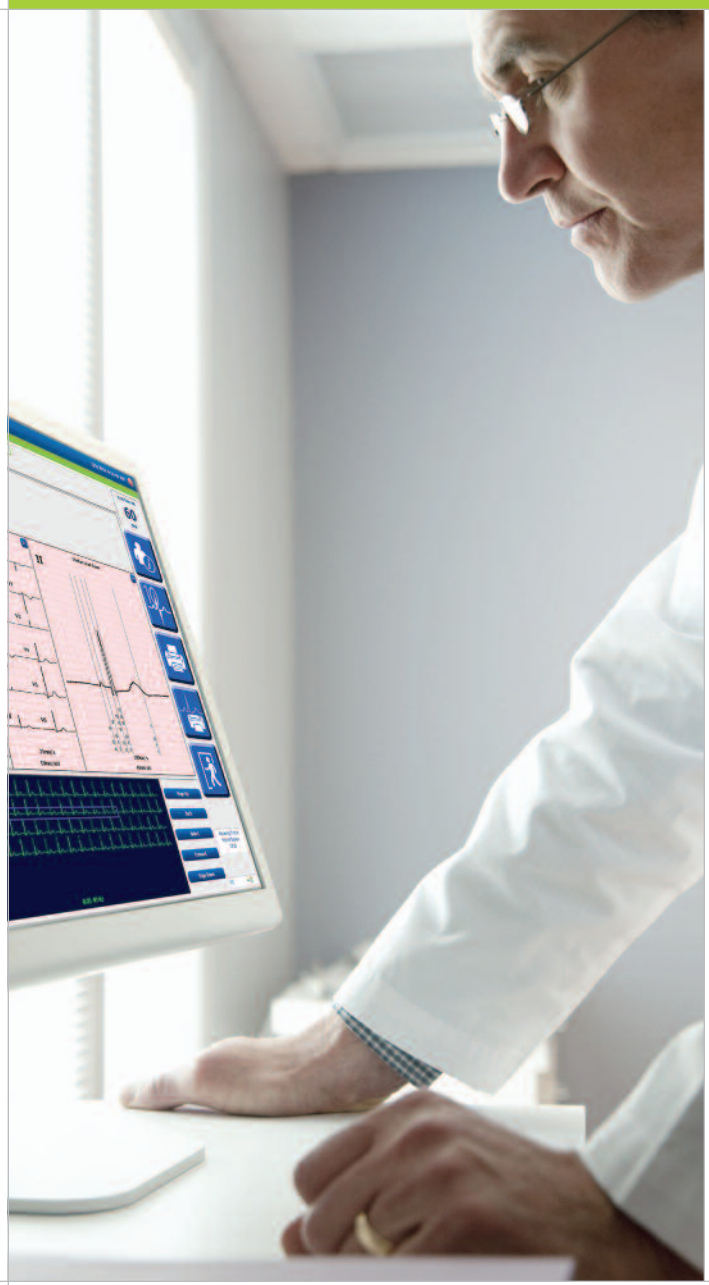

CARATERISTICAS DEL PRODUCTO

- **Integral, Sistema ECG basado en PC**
  RScribe™ 5 es un sistema avanzado, altamente escalable que permite eficacia clínica además de flexibilidad. Se puede utilizar como un dispositivo independiente o para aplicaciones más complejas, como una red de adquisición, almacenamiento y estación de revisión.
- **Tiempo de adquisición automatizada**
  RScribe 5 permite un tiempo programado de adquisición del ECG de 20 segundos de diferencia a una única adquisición al final de 60 minutos. Esto permite a los médicos adquirir ECG secuenciales durante STEMI o estudios farmacológicos.
- **Mediciones ECG en pantalla**
  RScribe 5 dispone mediciones de ECG que aparecen en pantalla y características de edición para un flujo de trabajo sin papeles. Cuando una copia en papel es necesario, el sistema emite informes en una amplia gama de formatos. RScribe 5 también proporciona múltiples plantillas para facilitar sus conclusiones diagnósticas finales.
- **Distinguido Algoritmo de Interpretación de ECG Mortara VERITAS™**
  Ampliamente reconocido el algoritmo de interpretación de ECG en reposo Mortara utiliza criterios específicos de género y de edad (adultos y pediátricos) para proporcionar una segunda opinión para interpretación del ECG.
- **Libertad inalámbrica**
  Equivalente en tamaño y peso a un cable de paciente tradicional, el WAM™ (módulo de adquisición inalámbrica) ofrece libertad de movimiento para adquirir electrocardiogramas. Sólo pulsar un botón en el WAM adquiere un ECG o imprime una tira de ritmo.
- **Intercambio de Información**
  Experimente los beneficios de la comunicación bidireccional con otros sistemas, incluyendo EMR, HIS, PACS mediante XML, PDF, y DICOM®. RScribe 5 también se integra con Athena, software multi-modalidad Mortara que permite un práctico almacenamiento de datos del ECG.

Mortara

RSCRIBE™ 5 SISTEMA ELECTROCARDIÓGRAFO DE REPOSO

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES*
CANALES DE ENTRADA	Adquisición simultanea de las 12 derivaciones
DERIVACIONES ESTÁNDAR QUE SE ADQUIEREN	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1,V2,V3,V4,V5,V6
VISUALIZACIÓN DE ONDAS	Compatible con: 1366x768, 1280x800, 1680x1050, 1920x1080, o 1920x1200 Compatible con: Microsoft® Windows® 7 Professional 32-bit o 64-bit
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	100 GB SATA hard disk drive minimum Memoria mínimo de 2GB 3 Puertos mínimos de USB
ARCHIVO	Red o discos USB externos
DISPOSITIVOS DE ENTRADA	Teclado estándar y ratón de 2 botones de desplazamiento
UNIDAD DE DVD	DVD-ROM
SOPORTE DE RED	Opción de utilizar el servidor de base de datos estándar de la industria
INFRAESTRUCTURA DE RED	100 Mbps de conexión o más requerido para su uso con el servidor
DISPOSITIVO DE IMPRESIÓN	HP 2055DN o HP Enterprise M601 con HPUPD PCL 5 driver or equivalent
FUNCIONES OPCIONALES	Algoritmo opcional de interpretación de ECG en reposo VERITAS de Mortara con criterios específicos de edad y sexo; opciones de conexión para comunicación bidireccional
HERRAMIENTAS EN PANTALLA	El tiempo y la amplitud de pinzas, 40 Hz y 150 Hz filtros de ruido, una variedad de diseños de plomo y rejilla Mediciones en tiempo y amplitud, 40 Hz y 250 Hz filtros de ruido, varios formatos de derivaciones y cuadricula
TASA DE MUESTREO DIGITAL	40,000 s/sec/canales canal utilizado para la detección de marcapasos espiga; 1000 s/seg/ canales usados para grabar y análisis
HERRAMIENTAS OPCIONES DE GANANCIA	2.5, 5, 10, 20
FORMATO DE IMPRESIÓN DE INFORMES	Estándar o Cabrera; 3+1, 3+3, 6, 6+6, o 12 canales
RITMO DE FORMATO DE IMPRESIÓN	Iniciativa individual de hasta 60 minutos de datos
RESPUESTA DE FRECUENCIA	0.05 – 300 Hz
FILTROS	Filtro de línea de base alto rendimiento, filtro de interferencias de CA 50/60 HZ, filtros de paso bajo de 40 Hz, 150 Hz, 300 Hz
REQUISITOS DE ENERGÍA	100 – 240 VAC at 50/60 Hz

*Especificaciones susceptibles a cambios sin previo aviso.

MORTARA INSTRUMENT, INC.
7865 North 86th Street
Milwaukee, WI 53224
U.S.A.
Tel: 414.354.1600
Tel: 800.231.7437
Service: 888.MORTARA
Fax: 414.354.4760

MORTARA RANGONI EUROPE, SRL
(European Headquarters)
Via Cimarosa 103/105
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy
Tel: +39.051.298.7811
Fax: +39.051.613.3582

MORTARA INSTRUMENT AUSTRALIA
PO Box 7568
Baulkham Hills NSW 2153
Unit 28, 9 Hoyle Avenue
Castle Hill NSW 2154
Australia
Tel: +61 2 8070 9303
Fax: +61 2 9899 9478

MORTARA DOLBY UK LTD.
Monitor House, Kerse Road
Stirling FK7 7RZ
Scotland
Tel: +44.1786.446640
Fax: +44.1786.446630

www.mortara.com | ISO 13485 CERTIFIED

GARANTÍA + ASISTENCIA
Mortara Instrumnet tiene el compromiso de proporcionar asistencia del máximo nivel a sus clientes. Consúltenos sobre el programa que mejor se adapte a sus necesidades.

RScribe™, VERITAS™, y WAM™ son marcas de Mortara Instrument, Inc.

Microsoft® and Windows® son marcas registradas de Microsoft Corp.

DICOM® es una marca registrada de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos por sus estándar de publicaciones relativas a las comunicaciones digitales de información médica.

ENG 2