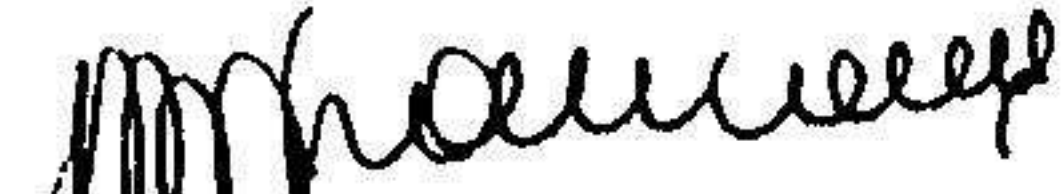


---AUTORIZÁSE a la firma IRAOLA y CIA SA, la ampliación de vida útil del Reactivo de Diagnóstico uso "in Vitro" de referencia, la que en lo sucesivo será de: **VEINTISIETE (27) MESES**, conservado entre 4 - 30°C.

---ACÉPTENSE el nuevo manual de instrucciones a fs. 29 a 34.

Expte. 19.659-07-1.-----Disp. 6666 -06-11-07.-----Bs. As. 11-01-08.

mem


Dra. Silvia Boni
Jefe del Departamento de Registro
ANMAT